

政府采购合同

合同编号：20251008

甲方：林西县医院
地址：赤峰市林西县林西镇东街

乙方：内蒙古佳品医疗器械销售有限公司
地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华西街 47 号大健康产业园 3 楼 305-306 的办
公用房

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中
华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 医疗设备采购项目 项目（填
写项目名称） CFZCLXS-G-H-250100 （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、
招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙
双方经平等协商。就如下合同条款达成一致意见。

一、 甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲
方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下： 详见附件一交付货物的名称及数量
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务
等详细内容，详见附件一货物清单。

二、 乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：自签订合同之日起 90 日历日内交货并完成安装调试。
（二）交付地点：林西县医院
（三）交付货物的名称及数量：如下

序号	产品名称	产品型号	数量	单价（万 元）	总价（万 元）	品牌
1	医用血管造影 X 射线机	Artis zee III ceiling	1	650	650	西门子
2	肌电图诱发电 位仪	NDI-092-C3	1	17.5	17.5	海神医疗
3	合计	¥6675000.00 大写：人民币陆佰陆拾柒万伍仟元整				

（四）乙方交付货物代表及联系电话：杨爱英 15734710171
（五）甲方接收货物代表及联系电话：敖其尔 15148350989

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交

付地点等。

三、 乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、 乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的 承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、 货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：汽运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、 甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 5 个日历日 内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物 5 日内，如发现质量问题，甲方应在 3 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 10 日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、 合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 ¥6675000.00 元
（小写）人民币陆佰陆拾柒万伍仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: 1、所有设备验收合格后支付合同总金额的 90%，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 90.00%，即¥6007500.00 元（大写：人民币陆佰万柒仟伍佰元整）；2、自设备验收合格之日起正常使用 1 年无质量问题后支付合同总金额 10%，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 10.00%，即¥667500.00 元（大写陆拾陆万柒仟伍佰元整）。

(二) 付款条件: 参考上一条付款时间及付款金额。

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古佳品医疗器械销售有限公司

开户银行: 交通银行内蒙古区分行

银行账号: 151000179015003016955

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 100% 的 货款 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期 1 日，乙方应按照合同总金额的 100% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 1 % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额1%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二) 向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式3份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构各执一份。。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分, 其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

无。


十七、本合同未尽事宜, 由双方另行签订补充协议, 补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：林西县医院（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2025年10月23日

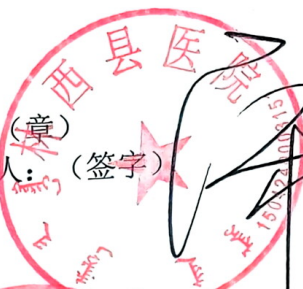

Handwritten signature of the representative of Linxi County Hospital.

乙方名称：内蒙古佳品医疗器械销售有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）刘尊林

2025年10月23日



Handwritten signature of Liu Zunlin.

附件一产品配置清单


医用血管造影 X 射线机配置



西门子医疗国智创新全新推出

新飞天悬吊式血管造影系统

配置简介

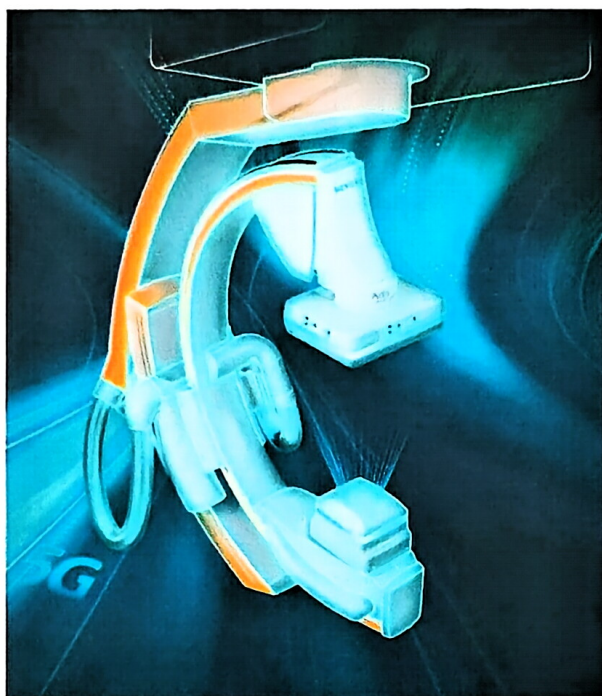

西门子医疗系统有限公司

新飞天配置简介

一、主系统

序号	说 明
1	Artis zee ceiling MAX 新飞天平板探测器血管造影系统
1.1	User-defined work positions & ICP (Intelligent Collision Protection) 工作位记忆存储模块及智能防撞保护系统
1.2	C-arm ceiling-mounted 悬吊C-臂
1.3	Operation System (Include Complete system operation at patient table side) 操作系统（包括：系统床旁控制组件）
1.4	Displaying system data 系统信息显示模块
1.5	Image system 数字成像系统
1.6	Image storage capacity 图像存储能力
1.7	Operating modes 采集操作模式
1.8	Image processing 图像处理技术
1.9	DVD / CD burner (DICOM) DVD/CD 光盘刻录(DICOM)

1.10	Networking 网络功能
1.11	X-ray generator X 线发生器
1.12	Accessories 附件
2	Combo Cardiology/Interv. Radiology 心脏及外周通用型血管造影功能
3	CARD Acquisition 心脏采集程序
4	40HDR flat detector 高清平板探测器 30cm x 38cm
5	MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80 X-ray tube assembly 至尊猫王X-线球管组件 (MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80)
6	Angio collimator Angio 准直器

二、辅助设备

序号	说 明
1	Table standard 标准导管床
2	Tabletop (narr.) /Mattress(thin) 床面 (窄型) / 床垫 (薄型)
3	Foot Switch Monopl. (Cable) 适用于单 C 臂的脚闸 (有线)
4	DCS w/2 D-19-D Live+Ref.+prep 显示器的悬吊装置, 配2台19英寸显示器
5	ACE Cable Set in Control room 控制室图像传输接线
6	Control room 1 D-19(Live) 19 英寸高对比度显示器用于控制室实时图像显示和 <i>syngo</i> 操作
7	Lower body radiation protection 下半身射线防护设施
8	Upper Body Rad.Protection 悬吊上半身放射防护屏
9	Examination lamp 手术灯
10	Interface for ctrl rm operation 控制室操作控制接口
11	Hand switch manual

	手动开关
12	<i>syngo</i> keyboard, USA 英文版本“新沟通”键盘
13	Intercom system 对讲系统
14	Customer documentation, English 用户手册（英文）
15	Customer documentation, Chinese 用户手册（中文）
16	Pre-install. Artis(monoplane) Artis 预安装
17	Pre-install. Artis Table, standard 导管床预安装
18	Factory Inst Artis zee mono Artis zee用户现场安装

三、CARE 主动射线防护系统

序号	说 明
1	CAREmatic 全自动曝光控制
2	CAREfilter 全自动滤波选择
3	CAREwatch 自动剂量检测
4	Digital Pulsed Fluoroscopy 数字脉冲透视技术
5	Fluoro Loop 透视循环回放功能
6	CAREvision 综合低剂量操作软件
7	CAREprofile 无射线准直器设定
8	CAREposition 无射线病人定位
9	Low Dose Acquisition 低剂量采集协议
10	CAREguard 皮肤剂量实时监控



11	CAREreport DICOM 剂量报告系统
12	CAREmonitor 剂量猫

四、CLEAR MAX 图像优化软件包

序号	说 明
1	Asymmetric Edge Enhancement AEE 智能边缘强化
2	CLEARcontrol 图像亮度控制
3	CLEARview 动态密度优化技术
4	CLEARvessel 血管边缘增强技术
5	CLEARmotion 动态降噪
6	CLEARchoice 自定义图像风格
7	CLEARmap 智能二维路图技术
8	CLEARmatch 二维图像实时像素位移修正

五、PURE 智能平台

序号	说 明
1	3D Wizard 3D 大师
2	Quickzoom 鹰眼
3	Heads-up Display 抬头显示
4	Parallel Patient Processing 并行处理
5	Bookmarks 智能书签

六、高级功能

序号	说 明
1	Touch screen at patient table side 床旁触摸控制屏
2	High Speed DSA Acquisition 高速DSA采集
3	DICOM RIS-Modality Worklist DICOM 检查排单接口
4	Vascular Analysis 血管分析软件
5	Automap 自动机架存储功能
6	2k Acquisition 2k 图像采集
7	Clear STENT 智能支架高清显像功能
8	CLEARstent Live + CLEARstent 实时支架精显+支架精显
9	PERISTEPPING (native) 实时步进血管造影
10	PERISTEPPING / PERIVISION 实时步进血管造影/实时步进 DSA
11	Mem. expansion 3 (50k - 1k Matrix) 存储扩充 3 (5 万幅 1k 矩阵)

七、高级选配件

序号	说 明
1	Overlay fade 参考图叠加技术
2	Detector and tube rotation 平板探测器及球管跟踪旋转功能
3	InFocus 伺服旋转
4	Neuro Device 颅内支架超清成像
原厂高级后处理工作站及高级功能	
5	X-workplace 原厂三维图像后处理工作站
5.1	Color Flatscreen Display 19" 19英寸彩色监视器 X2
6	syngo 3D reconstruction 三维血管重建功能
7	syngo Dual volume 双容积显示
8	syngo 3D Roadmap 三维导航功能

9	<i>syngo</i> DynaCT 类 CT 成像
10	<i>syngo</i> 2D/3D Fusion 2D/3D 图像融合技术
11	<i>syngo</i> 3D/3D Fusion 3D/3D 图像融合技术
12	<i>syngo</i> NeedleGuidance 穿刺导航

八. 远程介入大师Lite (Remote intervention master, RIM Lite)

序号	说 明
1	RIM Lite Main Hardware RIM Lite 设备端主要硬件
1.1	NUC Main Frame NUC 主控电脑
1.2	Touch Screen 触摸显示器
1.3	Speaker 视频会议扬声器
1.4	RIM Cable sets RIM 连接线缆套件
2	RIM Installation RIM 安装
3	RIM Cloud Service (Including one year unlimited cloud service) 云传输服务 (包含一年不限时云服务)
3.1	RIM Modality Client Software RIM 设备端软件
3.2	RIM WeChat Service -Software RIM 微信服务软件

高压注射器配置清单

配置清单

产品名称：高压造影注射系统

产品型号：Mark 7 Arterion™ 一体化落地式

	Item	Quantity
—	MEDRAD Mark 7 Arterion™ Base System MEDRAD Mark 7 Arterion™ 主机系统及核心部件	1
1	Assy, Power Supply Unit. 电源装置系统	1
2	Assy, Injector Head. 注射头	1
3	Assy, Display Control Unit. 显示控制装置（含可旋转触屏控制面板）	1
4	Jacket, Pressure 150ml. 针筒压力保护罩 150ml	1
5	CD, Operators Manual (Chinese). 中文操作手册（CD）	1
6	Form-Certificate of Compliance. 合格证书	1
7	Handswitch, 6". 手控开关	1
8	Handswitch Mount Kit. 手控开关安装配件	1
二	Assy, Pedestal, Mark 7 Arterion™. 基座系统	1
三	Articulating Arm. 主体连接臂	1
四	Assy, Fulcrum, Display Mount Kit. 显示器支撑安装配件	1
五	Cable, Display, 10ft. 显示控制器连接线（3米）	1
六	Heat Maintainer. 针筒保温套	1
七	Power Cord, China. 适用于中国的电源线	1
八	Pedestal ISI Cable. 影像设备同步电缆	1

监护仪配置清单

BeneVision N12配置单
N12主机(4槽)
12.1" 电容触摸屏(高清/16:9宽屏)
4G内置存储卡
国标电源线
HL7输出 (仅参数) 软件License
MPM1: NIBP + TEMP + Mindray SpO2 + 3/5-lead ECG + IBP
电极片+导联线+电缆: 5导, 成人, 按扣, 抗除颤型, AHA
Mindray血氧电缆+512E成人指套式传感器 (IPX7防水)
导气管+成人无内胆袖带 (CM1303 25-35cm)
配置 BIS 模块, 呼吸末二氧化碳模块
支持双有创血压监测, 支持分屏显示

肌电图诱发电位仪配置清单

NDI-092 肌电图诱发电位仪配置清单

☒ NDI-092-C3

序号	名 称	数量	单位
1	辅机	1	台
2	主机	1	台
3	监视器	1	台
4	键盘	1	个
5	鼠标	1	个
6	打印机	1	台
7	工作台	1	个
8	隔离电源	1	个
9	电线组件	1	根
10	前置器	1	个
11	编码器	1	个
12	闪光器	1	副
13	耳机	1	副
14	脚踏开关	1	个
15	双芯极缆	4	根
16	无关极缆	2	根
17	肌电针缆	1	根
18	以太网缆	1	根
19	手持电极	1	个
20	指环电极	1	个
21	鞍形电极	1	个
22	神经和肌肉刺激器用体表电极	1	包
23	医用一次性针电极	5	根
24	使用技术说明书	1	份
25	产品合格证	1	张

中标通知书

项目编号: CFZCLXS-G-H-250100



内蒙古佳品医疗器械销售有限公司:

林西县医院于2025年09月26日就医疗设备采购项目(项目编号: CFZCLXS-G-H-250100) 进行公开招标采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	全数字化通用型平板血管造影系统、肌电图诱发电位仪
中标金额(元)	6,675,000.00
合计金额(大写): 陆佰陆拾柒万伍仟元整	

